

# Human Granzyme B ELISA Kit

Catalog No.: RK00089

version: 2.0

**\*使用产品前，请务必阅读产品包装内说明书**

## 产品简介

本试剂盒产品使用夹心法定量测定人血清、血浆、细胞培养上清或其它生物体液中 Granzyme B 的含量。

## 产品检测原理

本实验采用双抗夹心 ELISA 法。将抗 Granzyme B 抗体预先包被在酶标板上，向微孔中分别加入标准品和样品，样本中 Granzyme B 与固相载体上的抗体结合。孵育后，未结合的样品在洗涤过程中会被洗去，加入抗 Granzyme B 的检测抗体，形成双抗体夹心。洗去未结合的检测抗体，然后向微孔中加入酶结合物。孵育和洗涤后，加入底物 TMB。样品中 Granzyme B 的含量与 TMB 反应的颜色深浅呈正相关，加入酸终止反应并测量吸光值。根据梯度稀释的 Granzyme B 标准品的吸光值绘制标准曲线并求出样品的浓度。

## 试剂盒组分及保存条件

未拆封的试剂盒可于 2-8°C 保存 1 年，已拆封的产品须在 1 个月内使用完。

| 组分                                                                                                      | 规格        | 货号      | 拆封后保存条件                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| 人 Granzyme B 预包被酶标板<br>Human Granzyme B<br>Microwell Plate Coated                                       | 8 ×12     | RM00384 | 将未使用的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，并重新密封，可在 2-8°C 存储 1 个月。 |
| 人 Granzyme B 冻干标准品<br>Human Granzyme B<br>Standard Lyophilized                                          | 2 支       | RM00381 | 复溶后不建议再次使用。                                 |
| 人 Granzyme B 浓缩生物素化抗体 (100×)<br>Human Granzyme B<br>Concentrated Biotin<br>Conjugate Antibody<br>(100×) | 1 ×120 μL | RM00382 | 可在 2-8°C 存储 1 个月。                           |
| 浓缩链霉亲和素-HRP (100×)<br>Streptavidin-HRP<br>Concentrated (100×)                                           | 1 ×120 μL | RM00383 | 可在 2-8°C 存储 1 个月。                           |

|                                                          |          |         |                   |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|
| 标准品/样本稀释液 (R1)<br>Standard/Sample Diluent (R1)           | 1 ×20 mL | RM00023 | 可在 2-8°C 存储 1 个月。 |
| 生物素化抗体稀释液 (R2)<br>Biotin-Conjugate Antibody Diluent (R2) | 1 ×12 mL | RM00024 |                   |
| 链霉亲和素-HRP 稀释液 (R3)<br>Streptavidin-HRP Diluent(R3)       | 1 ×12 mL | RM00025 |                   |
| 浓缩洗涤液 (20x)<br>Wash Buffer(20x)                          | 1 ×30 mL | RM00026 |                   |
| 显色底物 TMB<br>Substrate                                    | 1 ×12 mL | RM00027 |                   |
| 终止液 Stop Solution                                        | 1 ×6 mL  | RM00028 |                   |
| 封板膜 Plate Sealers                                        | 4 张      |         |                   |
| 说明书 Specification                                        | 1        |         |                   |

**\*特别提示：**表中所列为 96T 规格试剂盒，48T 试剂盒除标准品外，其他组分量均减半，请知悉。

## 实验所需的材料

1. 酶标仪，并配置主波长 450 nm，次波长 630 nm 或 570 nm。
2. 单/多通道移液器及吸头。
3. 去离子水或蒸馏水。
4. 洗瓶或是自动洗板机。
5. 恒温箱。
6. 灭菌的试管或是 EP 管，用于样本或是标准蛋白的稀释。

## 重要提示

\*本产品仅用于科研，不能用于临床诊断。

1. 请留意产品标签上的有效期时间，并在有效期前使用本产品。
2. 请勿将不同批次或者来自不同厂家的试剂混合使用。
3. 如测试获得的样本 OD 值超过了产品的最高检测限，请使用产品中的标准品/样本稀释液（R1）对样本进行稀释。所以，在正式测试样本前，建议先进行样本的预测试。
4. 实验过程中的加样、洗板、孵育时间、孵育温度等操作均会对最终结果造成影响，请严格管理实验流程并做好记录。
5. 样本的收集、处理及保存均会对检测结果产生影响，请务必严格管理样本的处理过程。
6. 在本试验中对所有因素进行试验之前，不能排除干扰的可能性。
7. 相关试剂中可能存在有害物质，使用中请注意佩戴手套，必要时

佩戴护目镜。


8. 终止液为腐蚀性液体，请做好相关防护。
9. 为保证最佳检测效果，相关试剂组分的保存请参照标签或是说明书。
10. 试剂配制后的混匀对检测结果非常重要，但部分蛋白或是抗体可能对剧烈的涡旋非常敏感，可能造成活性损失，请谨慎使用涡旋。
11. 请使用灭菌的耗材进行试剂配制，以免造成试剂污染，影响最终检测结果。
12. 为保证最佳检测效果，溶解后的标准蛋白及相关试剂的工作液不建议冻存后重复使用。
13. 产品在储存或是使用中，请注意避光。
14. 为保证最佳检测效果，在加不同样本时，请注意更换吸头。
15. 请严格按照说明书的要求进行试剂配制。如果您将分次使用试剂盒，请使用封口袋密封好预包被板，并且在开封后的 1 个月内使用完。
16. 48T 的试剂盒也同样可参考说明书进行实验。

## 样本收集与保存

1. 细胞培养上清：1000 xg 离心 10 分钟，及时检测；或将样本置于-20 至-70℃中分装保存（24 小时内检测可置于 2-8℃），避免反复冻融。如果细胞培养上清样本的稀释度比较大，可先用培养基进行中间的稀释，最后用标准品/样本稀释液(R1)稀释。
2. 血清：使用血清分离管，分离血清前让样品凝结 30 分钟，1000 xg 离心 10 分钟并及时检测；或将样本置于-20℃至-70℃中分装保存（24 小时内检测可置于 2-8℃），避免反复冻融。
3. 血浆：收集血浆时用 EDTA 或肝素作为抗凝剂，在 30 分钟内 1000 xg 离心 15 分钟收集样本，及时检测；或将样本置于-20℃至-70℃中分装保存（24 小时内检测可置于 2-8℃），避免反复冻融。
4. 其它生物体液：1000xg 离心 20 分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20℃ 或-80℃保存，避免反复冻融。
5. 避免使用溶血、高血脂血清/血浆样本。

## 试剂准备

1. 使用前将所需使用的试剂平衡至室温。如果浓缩液中有结晶析出，需要将试剂置于室温轻轻摇动，直至晶体完全溶解。
2. 标准品：向冻干品中加入 1.0mL 的标准品/样本稀释液 R1，轻轻混匀至少 15min，使冻干品完全溶解至浓度为 1000pg/mL。按照下图准备好包含 R1 稀释液的 EP 管，并按照提示进行梯度稀释（建议标准曲线使用以下浓度：100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13, 1.56, 0pg/mL）。

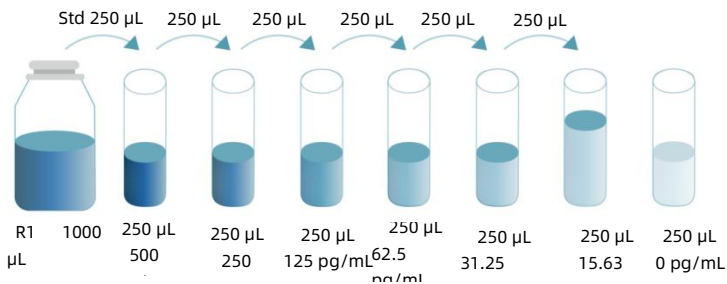

3. 浓缩生物素化抗体(100x):在使用前用生物素化抗体稀释液(R2)将浓缩生物素化抗体以 1: 100 的比例稀释，注意：稀释后的工作液应在 30 分钟内使用。
4. 浓缩链霉亲和素-HRP (100x)：在使用前用链霉亲和素-HRP 稀释液(R3)将浓缩链霉亲和素-HRP 以 1: 100 的比例稀释。注意：稀释后的工作液应在 30 分钟内使用。

5. 洗涤液：在使用前用双蒸水或去离子水将洗涤液以 1: 20 的比例稀释。

## 样本准备

不同的样本需要根据具体情况选择合适的稀释倍数，稀释样本请使用试剂盒内的标准品/样本稀释液（R1）。

1. 细胞上清：由于细胞上清样本因实验条件不同，呈现较大的差异，故细胞上清样本建议进行预测试来决定合适的稀释倍数，样本稀释请使用标准品/样本稀释液（R1）或是 PBS。

2. 血清/血浆：正常样本推荐原液检测。

由于存在个体差异，请提前预估样本的浓度范围，并通过预实验确定待检样本的稀释倍数。

样本稀释请使用标准品/样本稀释液（R1）。

参考稀释方案如下：

稀释 100 倍：一步稀释。取 5  $\mu$ L 样本到 495  $\mu$ L 标准品/样本稀释液（R1）内，做 100 倍稀释；

稀释 1000 倍：两步稀释。取 5  $\mu$ L 样本到 95  $\mu$ L 标准品/样本稀释液（R1）内，做 20 倍稀释，再取 5  $\mu$ L 20 倍稀释样本到 245  $\mu$ L 标准品/样本稀释液（R1）内，做 50 倍稀释，总共稀释 1000 倍；每步稀释时取液量不少于 3  $\mu$ L，稀释倍数不超过 100 倍。每步稀释都需混合均匀，避免起泡。

## 实验步骤

为获得理想的实验结果，请注意，所需使用的试剂在使用前平衡到室温。建议所有标准品、对照品和样品均做复孔测试。

1. 按照前几节的指示准备好所有试剂、工作标准品和样品。从板框上取下待用的微孔板条，将剩余的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，然后重新密封保存。
2. 每孔加入 1x 洗涤缓冲液 350  $\mu\text{L}$ ，静置 40 秒后弃去液体，该步骤共洗涤 3 次。
3. 在空白孔中添加 100  $\mu\text{L}$  标准品/样本稀释液 (R1)。
4. 在其他孔中分别加入 100  $\mu\text{L}$  不同浓度的标准品或样品，用提供的封板膜封闭板孔，37°C 孵育 2 小时。
5. 在使用前 15 分钟配制好生物素化抗体 (100x) 工作液。
6. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。
7. 每孔中加入生物素化抗体工作液 (100  $\mu\text{L}$ /孔)，并盖上新的封板膜，37°C 下孵育 1 小时。
8. 使用前 15 分钟配制好链霉亲和素-HRP (100x) 的工作液。
9. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。
10. 每孔中加入链霉亲和素-HRP 工作液 (100  $\mu\text{L}$ /孔)，并盖上新的封板膜，37°C 孵育 30 分钟。
11. 预热酶标仪。
12. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。
13. 向孔中加入 TMB 底物 (100  $\mu\text{L}$ /孔)。在 37°C 下避光孵育 15-20

分钟。

14. 加入终止液（50  $\mu\text{L}$ /孔），并立即放入酶标仪，在 5min 内测定每个孔 450nm 的 OD 值。 如果可以选择校正波长，则设置为 570 nm 或 630 nm。并从 450 nm 的读数中减去 570 nm 或 630 nm 的读数，这种方式可以校正并去除非显色物质的 OD 值，从而获得更准确的检测结果。如果无法选择校正波长，则获得的读数将偏高，导致读数的准确度下降。

## 简要实验流程

准备好需要的标准品和试剂

洗板 3 次



向孔中加入 100  $\mu\text{L}$  标准品或待测样本

37°C 孵育 2 小时, 然后洗板 3 次



每孔加 100  $\mu\text{L}$  生物素化抗体工作液

37°C 孵育 1 小时, 然后洗板 3 次



每孔加 100  $\mu\text{L}$  链霉亲和素-HRP 工作液

37°C 孵育 0.5 小时, 然后洗板 3 次



加入 100  $\mu\text{L}$  底物溶液, 37°C 避光, 孵育 15-20 分钟



加入 50  $\mu\text{L}$  终止液



5min 内检测 450nm 波长的 OD 值


校正波长设置为 570nm 或 630nm

## 结果计算

1. 计算标准蛋白各浓度、质控、样本等复孔的平均 OD 值，每个测试的 OD 值都应减去空白孔的 OD 值以及次波长的 OD 值。
2. 使用测试获得的 OD 值绘制标准曲线，推荐使用 4-PL 拟合，具体也可根据需求选择其他拟合方式来绘制标准曲线。使用计算机软件以吸光度 OD 值为纵坐标（Y），相应的 Granzyme B 标准品浓度为横坐标（X），绘制标准曲线。样品的含量可根据其 OD 值由标准曲线计算出相应的浓度。
3. 如果样本在上样检测时进行了稀释，那么计算获得浓度需要乘以相应的稀释倍数。

## 典型数据

此标准曲线图仅供参考，计算实验结果请以实际实验数据进行。

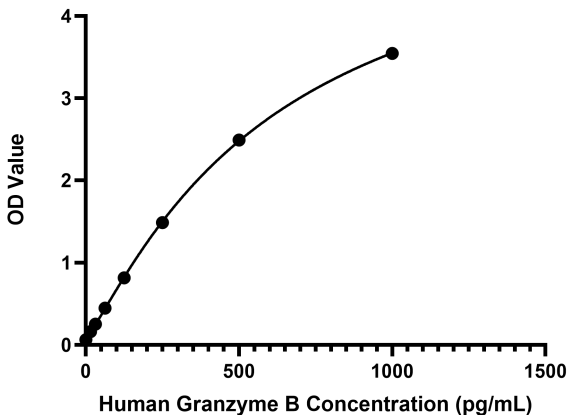

## 检测范围

15.63-1000pg/mL

## 灵敏度

最低检测 Granzyme B 可达 4.89 pg/mL。

重复测定空白样本 20 次，计算 20 次反应测得的均值 ( $\bar{X}$ ) 和标准差

(SD)，以  $\bar{X}+2SD$  计算出相应的浓度，即为分析灵敏度。

## 特异性

本试剂盒可用于检测重组/天然人 Granzyme B。

该方法对 Granzyme B 的检测具有较高的灵敏度和特异性。

Granzyme B 与类似物无明显交叉反应或干扰。

以 10ng/mL 平行做特异性试验，与下列蛋白均未见发生交叉反应。

| 重组人               | 重组小鼠 | 重组大鼠 |
|-------------------|------|------|
| BDNF              | BDNF | BDNF |
| FGF basic         |      |      |
| IL-5              |      |      |
| IL-8/CXCL8        |      |      |
| IL-13             |      |      |
| GM-CSF            |      |      |
| IFN-gamma         |      |      |
| Leptin            |      |      |
| MIP-3 alpha/CCL20 |      |      |
| TIMP-1            |      |      |
| TIMP-2            |      |      |

注意：

由于现有的技术和知识的限制，我们不可能完成 Granzyme B 与所有类似物之间的交叉反应检测，因此交叉反应可能仍然存在。

## 精密度

### 批内差

在同一块板上重复测试三个已知浓度的样品 20 次，计算浓度的变异系数（CV）。

批内 CV<10%。

### 批间差

用两批试剂盒对三个已知浓度的样品分别进行 20 次测试，计算浓度的变异系数（CV）。

批间 CV<15%。

|            | 批内精密度 |        |        | 批间精密度 |        |        |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 样本         | 1     | 2      | 3      | 1     | 2      | 3      |
| 数量         | 20    | 20     | 20     | 20    | 20     | 20     |
| 浓度(pg/mL)  | 38.66 | 110.02 | 666.75 | 39.79 | 116.45 | 625.21 |
| 标准偏差 (SD)  | 3.26  | 8.91   | 61.55  | 2.38  | 1.98   | 14.85  |
| 变异系数 CV(%) | 8.43  | 8.09   | 9.23   | 5.99  | 1.70   | 2.38   |

## 回收率

将高、中、低 3 个不同浓度的 Granzyme B 蛋白加入到对应的样本中检测，并计算蛋白的回收率（实际测试的样本浓度/理论样本浓度 x100%）。

| 样本类型      | 平均回收率（%） | 范围（%）  |
|-----------|----------|--------|
| 细胞上清(n=5) | 97       | 85-103 |
| 血清(n=5)   | 94       | 91-106 |

## 线性

将高浓度 Granzyme B 加入样本中，在标准曲线范围内稀释并计算线性。

| /    | /         | 细胞上清(n=5) | 血清(n=5) |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1:2  | 平均符合率 (%) | 100       | 84      |
|      | 范围 (%)    | 95-105    | 82-90   |
| 1:4  | 平均符合率 (%) | 101       | 82      |
|      | 范围 (%)    | 97-102    | 80-89   |
| 1:8  | 平均符合率 (%) | 102       | 89      |
|      | 范围 (%)    | 98-101    | 84-92   |
| 1:16 | 平均符合率 (%) | 101       | 90      |
|      | 范围 (%)    | 99-102    | 82-95   |

## ELISA 常见问题分析及解决方法

| 问题描述        | 可能原因         | 解决方法                              |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 高背景值        | 洗板不充分        | 按要求充分洗涤，保证洗板时间、次数及每孔加样量无误         |
|             | 孵育条件不正确      | 检查孵育时间、温度是否按要求进行                  |
|             | 试剂、样本的交叉污染   | 注意实验过程中可能造成样本交叉污染的操作；配制新鲜的试剂，重复测试 |
| 无信号值或过低的信号值 | 试剂配制和使用错误    | 检查试剂配制浓度是否正确，是否按照顺序使用             |
|             | 酶标仪使用、设置不正确  | 提前预热；设置正确的主、次波长读数                 |
|             | 显色时间过短       | 最佳显色时间应控制在 15-25min               |
|             | 终止后，未及时读数    | 加入终止液后，在 5min 内读数                 |
|             | 样本基质效应       | 使用阳性质控品对照测试                       |
| 过强的信号值      | TMB 底物变质     | 检查 TMB 底物是否变蓝，使用新的底物试剂            |
|             |              | 避免使用金属物质接触底物造成变质失效                |
|             | 每步实验未更换新的封板膜 | 每步实验更换新的封板膜                       |
|             | 样本中目标蛋白量过高   | 预测试，选择适当稀释倍数测试                    |

|      |           |             |
|------|-----------|-------------|
| 重复性差 | 加样量不均一    | 检查移液器，定期校准  |
|      | 样本有杂质或沉淀物 | 样本使用前，请离心样本 |
|      | 试剂配制未充分混匀 | 加样前充分混匀试剂   |

\*仅供科研使用，不可用于治疗或诊断目的。